


温泉水のアニオン分析 e-HPLCことりMタイプで測定

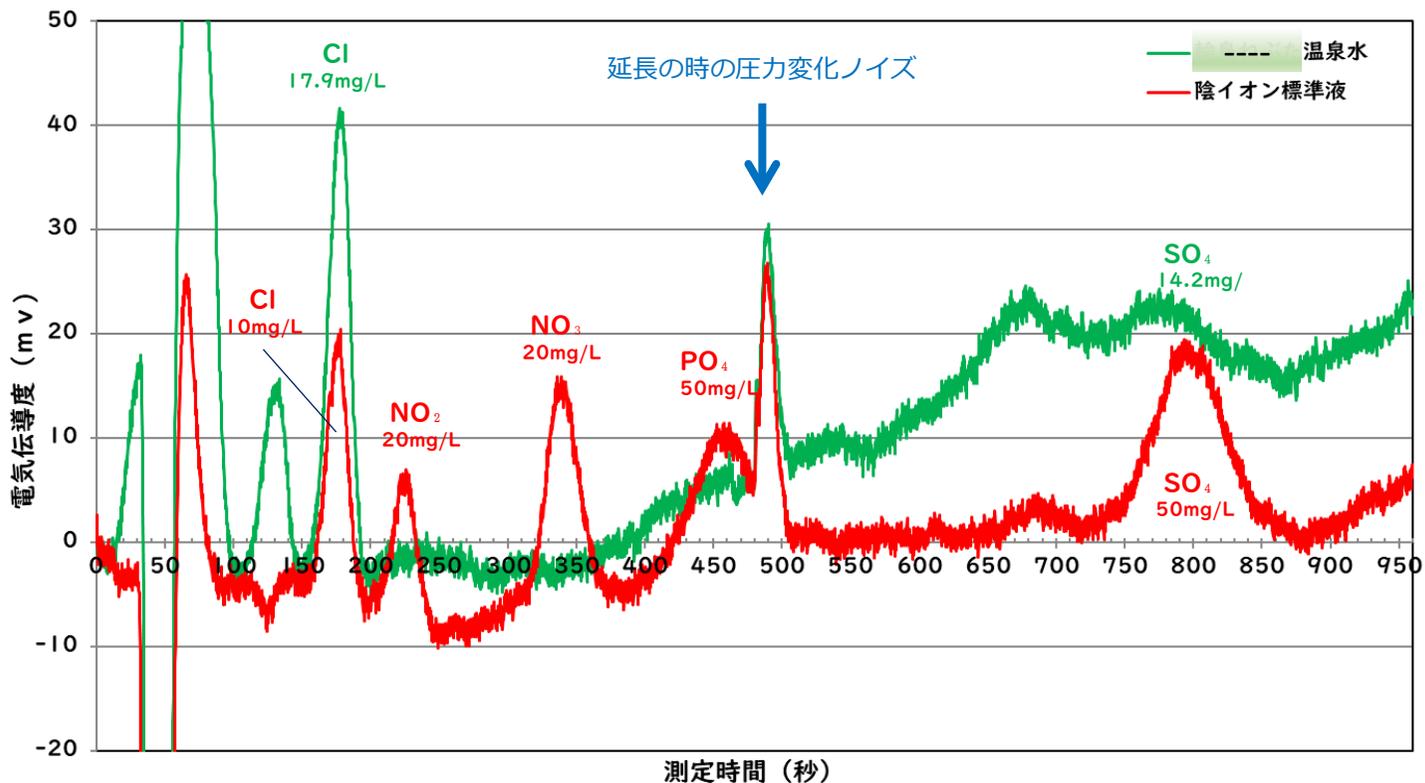

<測定条件>

分析時間 480秒×延長2回

サンプル量 100μl

流量 1200μl/min

カラム TSKgel IC-Anion-PW Φ4.6×50mm
(東ソー株式会社製)

検出器 電気伝導度検出器

溶離液 1.5mmol/L グルコン酸カリウム

1.1mmol/L 砂

30mmol/L 砂酸

15.0% アセトニトリル

0.5% グリセリン